


Diktering

Nyheter 5.1

Ny inställning vid skapande av nytt diktat

Vid skapande av Nytt diktat ska typ av diktafon väljas i fältet *Inspelningsläge*. Valet sparas automatiskt och används som standard vid kommande diktat.

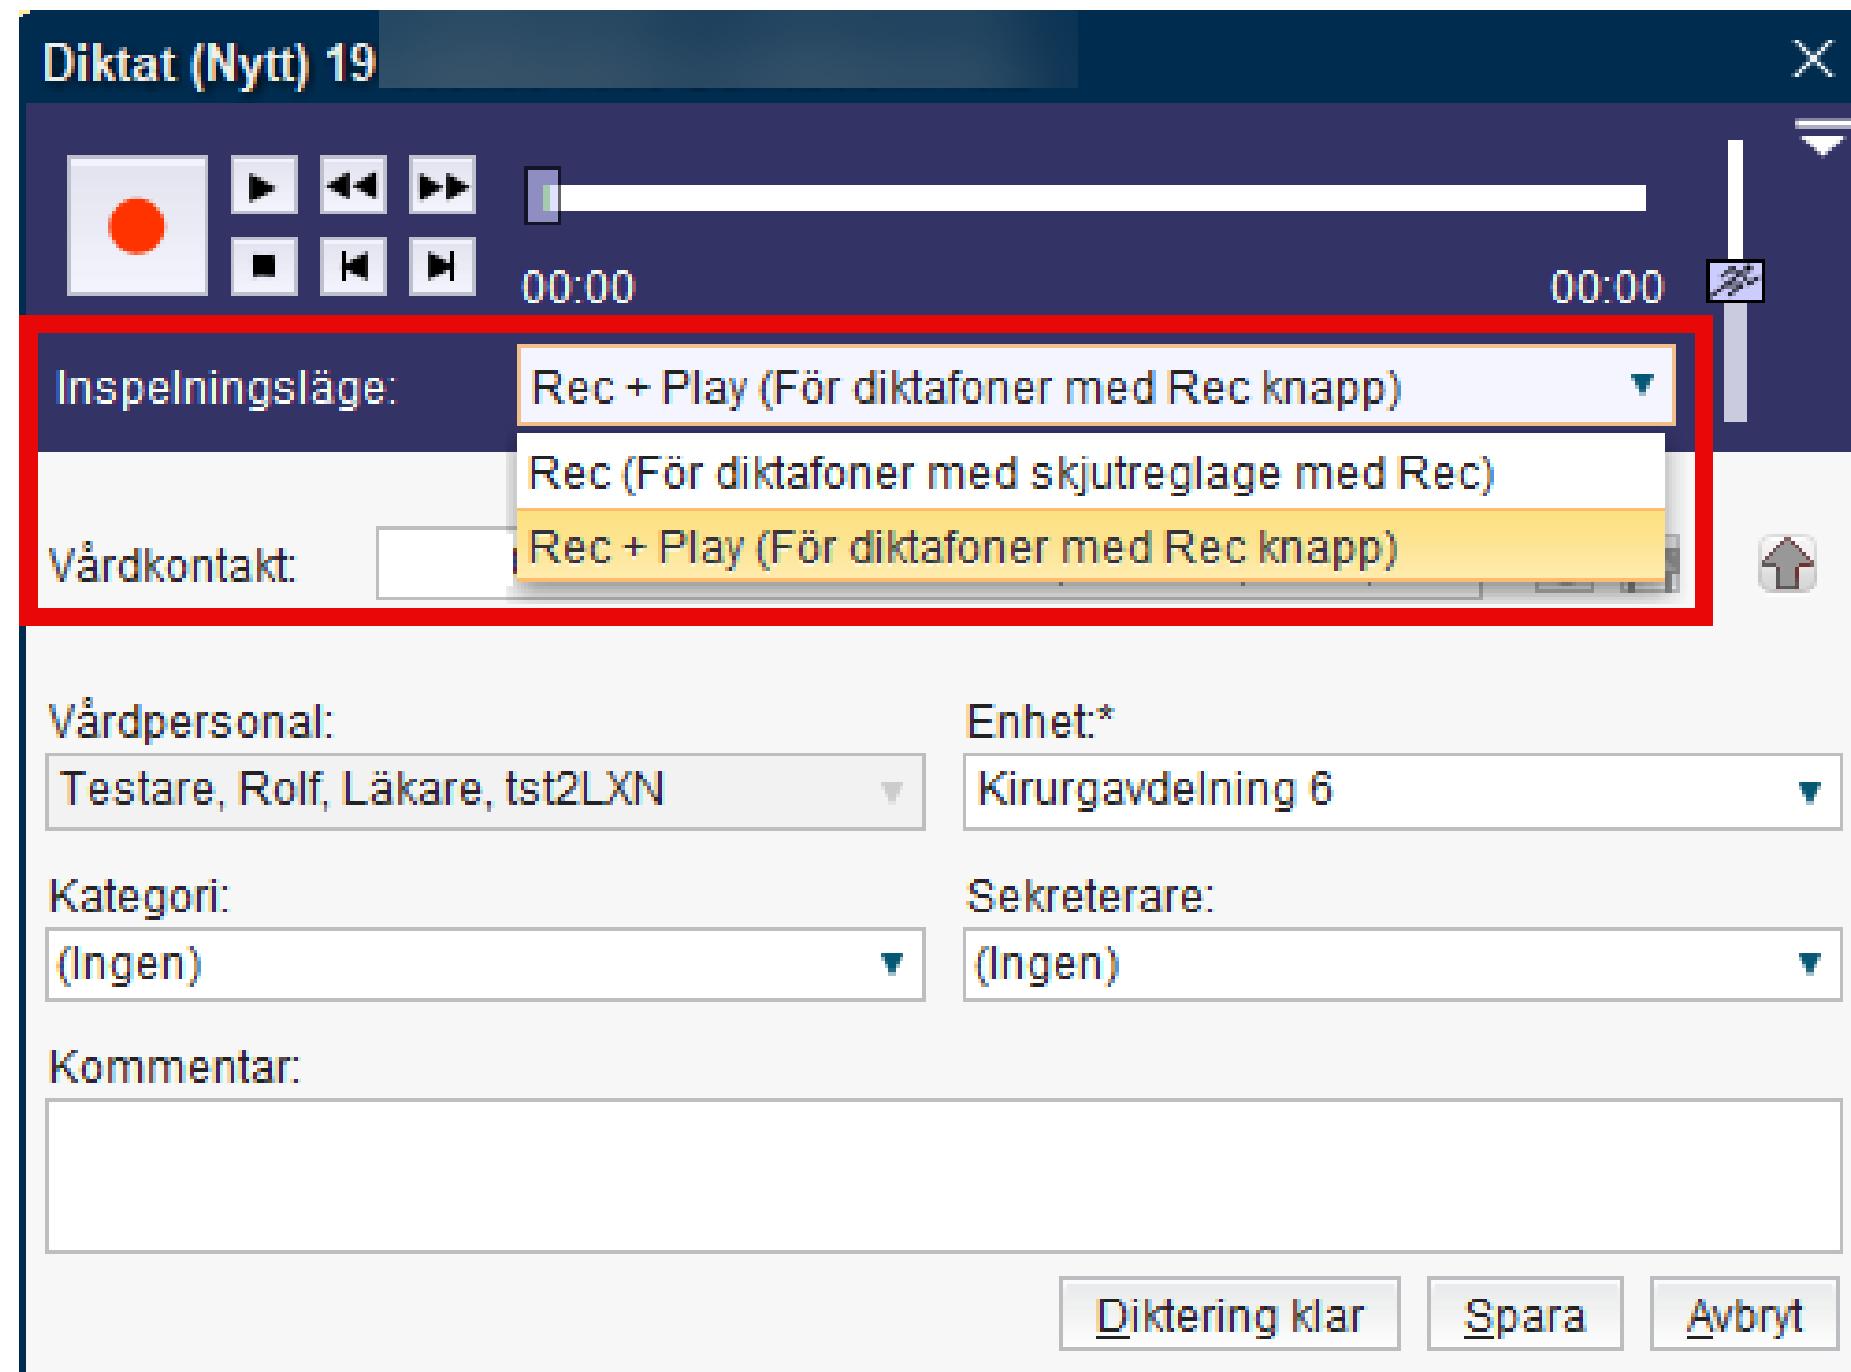

The screenshot shows a software window titled "Diktat (Nytt) 19". At the top, there is a playback control bar with a red record button, play/pause buttons, a progress slider, and a volume control. Below this, the "Inspelningsläge:" dropdown menu is open, showing three options: "Rec + Play (För diktafoner med Rec knapp)", "Rec (För diktafoner med skjutreglage med Rec)", and "Rec + Play (För diktafoner med Rec knapp)". The third option is highlighted in yellow. Below the dropdown is a "Vårdkontakt:" field. Further down, there are fields for "Vårdpersonal:" (containing "Testare, Rolf, Läkare, tst2LXN"), "Enhet:*" (containing "Kirurgavdelning 6"), "Kategori:" (containing "(Ingen)"), and "Sekreterare:" (containing "(Ingen)"). At the bottom, there is a "Kommentar:" text area and three buttons: "Diktering klar", "Spara", and "Avbryt".